



KLASSNINGSPÅN

DRAGSKÅP MED SKYDDSVENTILATION MEN UTAN SPILLSKYDD

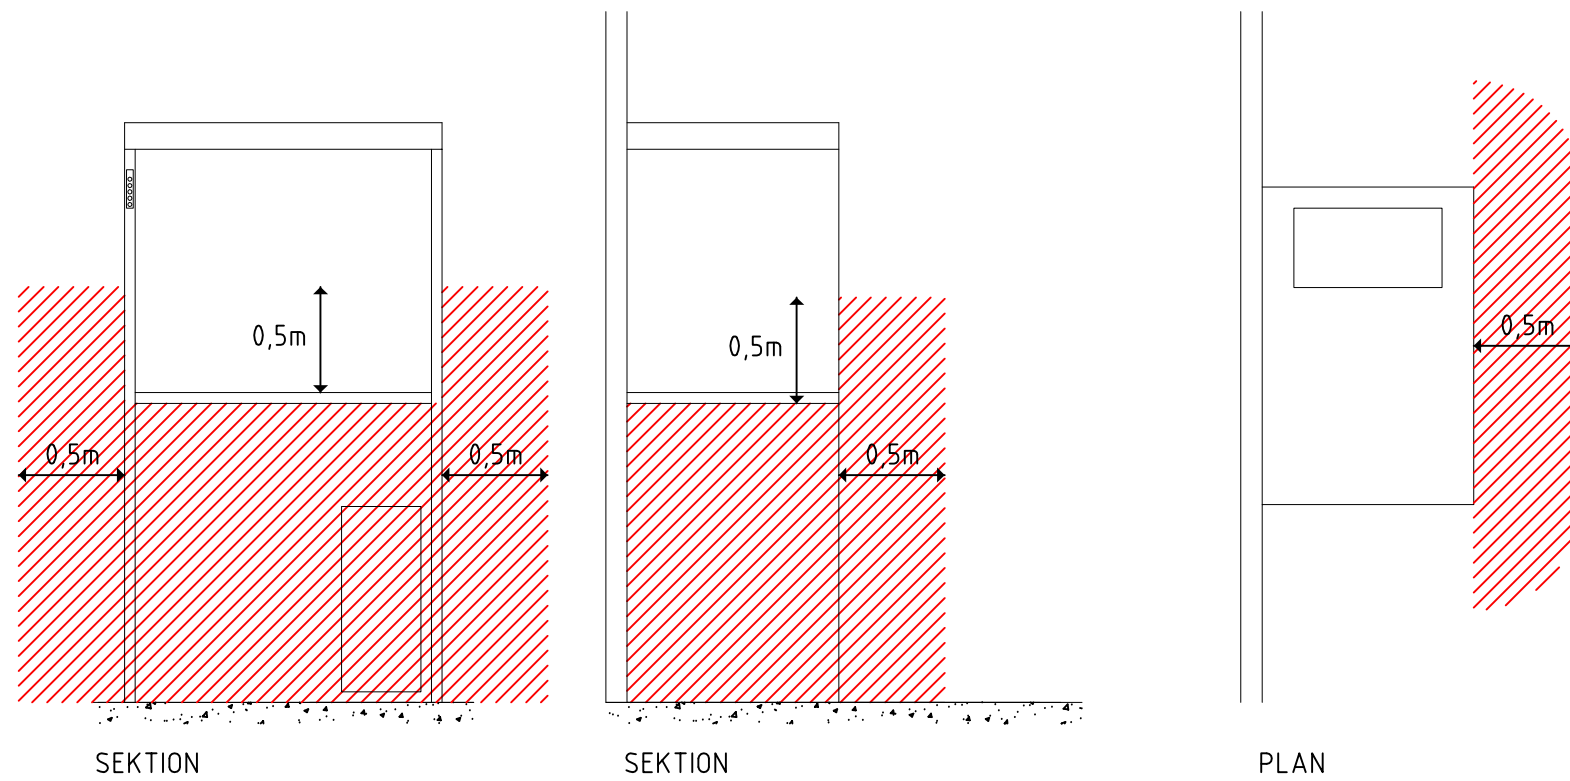

DRAGSKÅP MED SKYDDSVENTILATION OCH SPILLSKYDD GER INGA KLASSADE ZONER

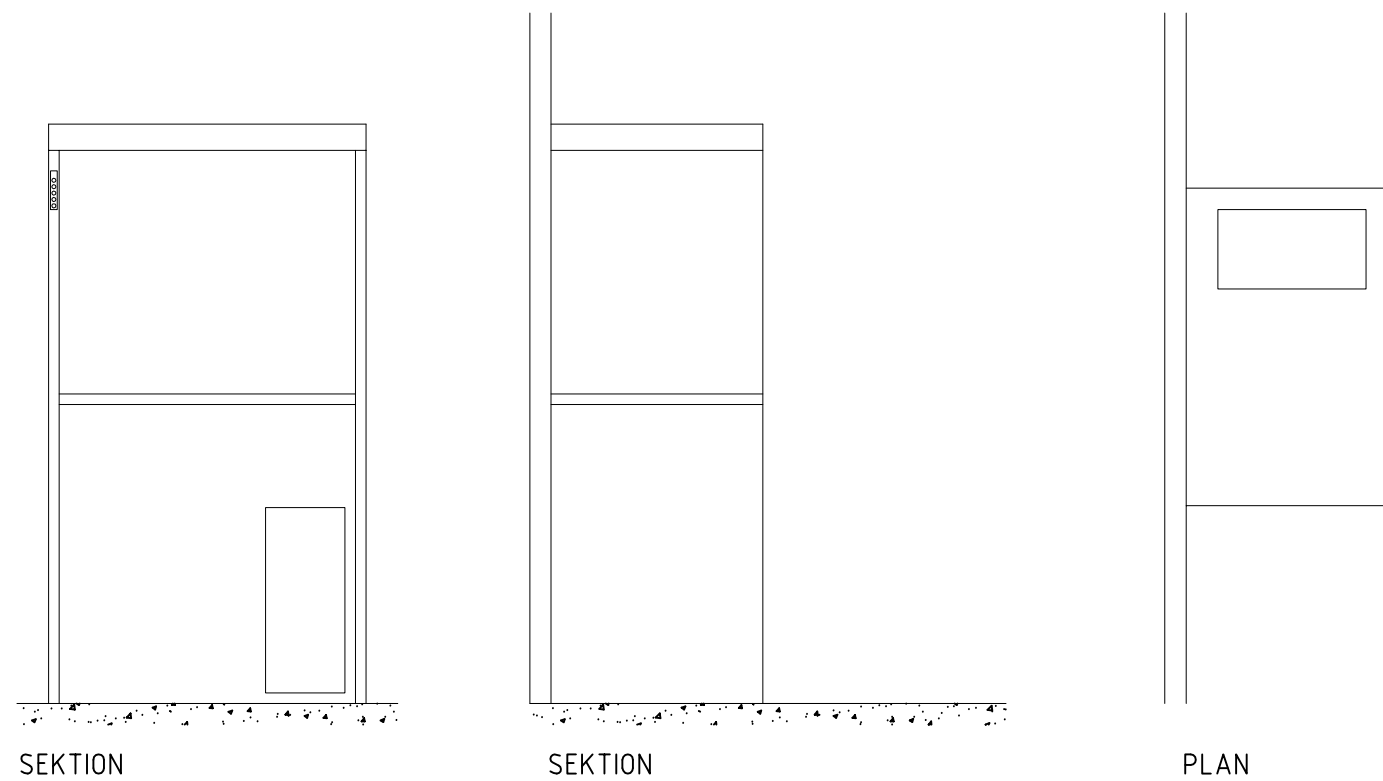

KLASSNING

KLASSNINGSGRUNDER ENLIGT
SEK HANDBOK 426 (UTG 4)

ÄMNE SOM HANTERAS OCH LAGRAS:
DIV. BRANDFARLIG VÄTSKA


TEMPERATURKLASS: T3


EXPLOSIONSGRUPP: IIB


ZON 0 -

ZON 1 -

ZON 2 INGEN KLASSNING I SKÅPET,
MEN UTANFÖR UPPKOMMER ETT
RISKOMRÅDE, SOM STRÄCKER
SIG 0,5m UT FRÅN DRAGSKÅPS-
ÖPPNINGEN OCH 0,5m OVANFÖR
DRAGSKÅPETS ARBETSUTA,
NED TILL GOLV SAMT UNDER
SKÅPET

 ZON 0 RISKOMR I VILKET EN
EXPLOSIV GASBLAND-
NING FÖREKOMMER
STÄNDIGT ELLER LÅNG-
VARIGT.

 ZON 1 RISKOMR I VILKET EN
EXPLOSIV GASBLAND-
NING FÖRVÄNTAS FÖRE-
KOMMA TILLFÄLLIGT VID
NORMAL HANTERING.

 ZON 2 RISKOMRÅDE I VILKET
EXPLOSIV GASBLAND-
NING INTE FÖRVÄNTAS
FÖREKOMMA VID NORMAL
HANTERING OCH OM DEN
LIKVÅL FÖREKOMMER,
I SÅ FALL ENDAST
SÅLLAN ELLER KORT-
VARIGT.

VENTILATIONSKANAL KLASSAS LIKA
SOM DET OMRÅDE VARIFRÅN LUFTEN
SUGS, FRAM TILL SAMLINGSKANAL DÅR
UTSPÄDNING SKER.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

KLASSNINGSPÅN

KEMISKA INSTITUTIONEN, KEMICENTRUM
LUNDS UNIVERSITET

UPPDRAG NR 60202071	RITAD/KONSTR AV JJ	HANDELAGGARE JK
------------------------	-----------------------	--------------------

DATUM 2015-01-12	ANSVARIG JAKOB KARLSSON
---------------------	----------------------------

 Bengt Dahlgren Brand & Risk AB
Sällersågsågen 11D
212 18 Malmå
Telefon: 040-6351700
Fax: 040-6351701
VVS - Energå & Miljö - Styr & Övervakning
Brand & Risk - Teknisk Förvalning
Org.nr: 556726-7488

SKALA EJ SKALA	NUMMER KL- G, H	BET
-------------------	--------------------	-----